



Matériel de laboratoire pour le BTP

CIMENT

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

APPAREIL DE VICAT

Code produit

UTCM-0450E	Ensemble Vicat EN
UTCM-0450A	Ensemble Vicat ASTM
UTCM-0451	Appareil Vicat (bâti)
UTCM-0452E	Moule Vicat EN Base ID 80 mm, haut ID 70 mm, hauteur 40 mm
UTCM-0452A	Moule Vicat ASTM ID Base 70 mm, haut ID 60 mm, hauteur 40 mm
UTCM-0453E	Aiguille Vicat initiale EN 1,13 mm dia.
UTCM-0453A	Aiguille Vicat ASTM 1 mm dia.
UTCM-0454E	Aiguille Vicat finale EN 1,13 mm dia.
UTCM-0455	Consistance Plongeur 10 mm dia.
UTCM-0456E	Plaque de verre
UTCM-0456A	Plaque de verre
UTGP-0121	Bac de transfert pour UTCM-0450E et UTB - 0120
UTGT -1305	Thermomètre en verre Max. 110 ° C
UTCM-0457	Poids additionnel, 700 gr, EN 480-2

Normes


EN 196-3, 480-2; ASTM C187, C191; AASHTO T129, T131

L'ensemble Vicat est utilisé pour déterminer le temps de prise et la consistance du ciment par la méthode Vicat.


UTGP-0121 Bac de transfert utilisé comme récipient d'eau EN, pour positionner le moule Vicat sous l'eau.

L'ensemble Vicat est fourni avec;

- Moule Vicat
- Aiguilles initiales et finales (pour EN)
- Aiguille Vicat (pour ASTM)
- Sonde de consistance
- Plaque de support
- Thermomètre en verre
- Bac de transfert (pour EN)

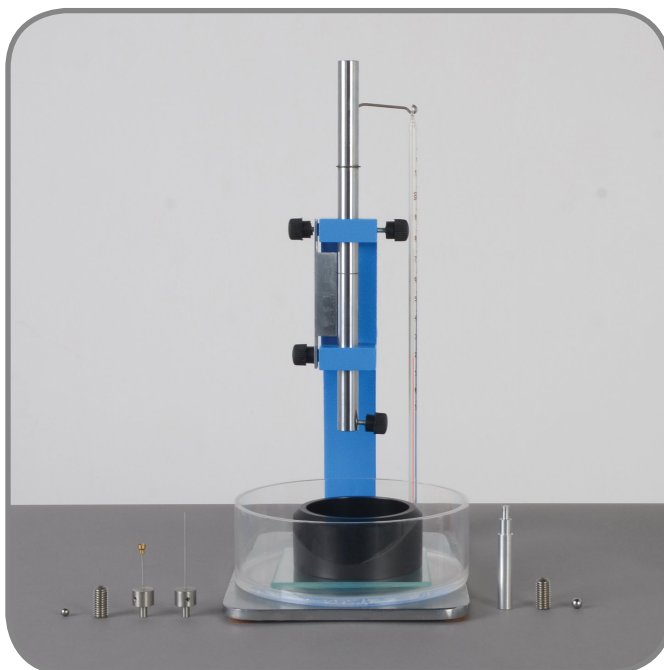

Vicat EN

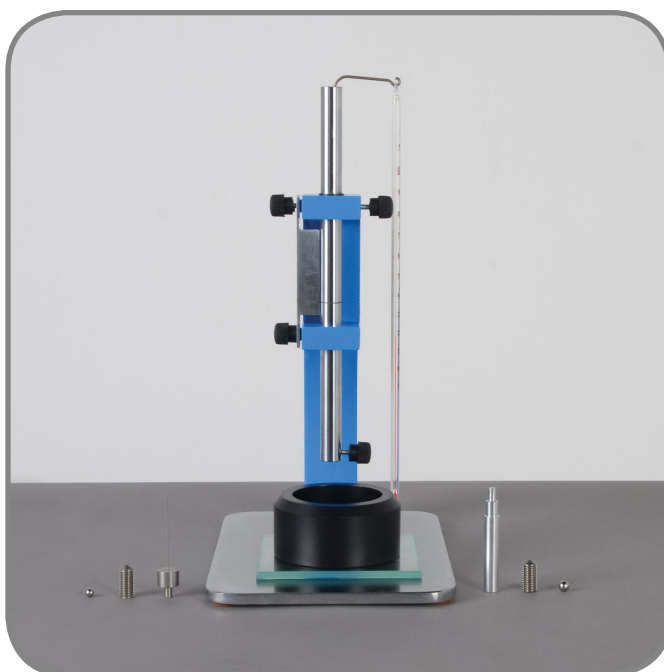

Vicat ASTM

Dimensions	150x190x318 mm
Poids (approx.)	3 kg